

DENNETSU

デンネツ殺菌ボックス

きよめ

KIYOME

クリアファイル除菌タイプ



取扱説明書

目 次


	ページ
1. KIYOME “特徴” / 2. 基本機能	1
3. 付属品 / 4. 付属品の取付	2
5. 紫外線ランプの交換方法	3
6. メンテナンス / 7. お問合せ	4
8. 保証書	5

1. KIYOME “特徴”

1. 省スペースの卓上型。 (Option : 自立スタンド型)
 - ・ Option : 棚数を追加することによるカストマイズ仕様可能。
2. 高性能の紫外線除菌ランプ
 - ・ 長寿命で且つ高い除菌効果維持率をもつデンネット特殊除菌ランプ（3本）を使用。
 - ・ 殺菌照射力85%維持の特殊除菌ランプ。
 - ・ 点灯遅延を許さない瞬時点灯の特殊除菌ランプ。
3. 高い反射率のアルミ素材(95%以上)
 - ・ 庫内は高反射率のアルミ素材を採用。
4. 庫内は乱反射のアルマイト処理
 - ・ アルマイト処理による凹凸表面。
 - ・ 紫外線の乱反射によりあらゆる角度から照射。
5. 高性能除菌効果
 - ・ 2. 3. & 4 効果により高性能除菌ボックスを生み出しました。
 - ・ クロコウジカビ除菌の基本設計。
6. 消毒時間は標準90秒

2. 基本機能

除菌ランプは高品質長寿命の特殊ランプ採用。 @11W 3本の33W、高反射板との組み合わせの省力殺菌照射設計。

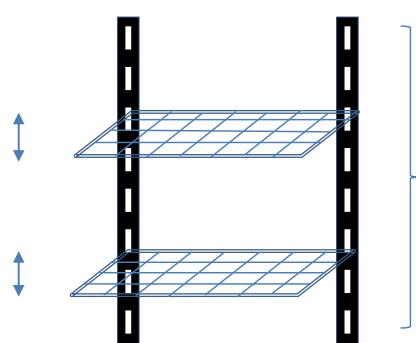

外寸： 幅 494 × 奥行 450 × 高さ 620
内寸： 幅 390 × 奥行 350 × 高さ 460


※棚はオプションとなります。

3. 付属品

以下の本体・付属品をご確認ください。

□ 除菌ランプ

- 天井部
- 左右側面
(3本)



取付の確認
ガードフレーム
除菌ランプ
• 外れ
• がたつき
• 破損

4. ブラケット取付 (オプション)

□ ブラケット L-300


取り付け
(差し込む)



□ 棚 DHBN 2840



取り外し
(指で挟む)

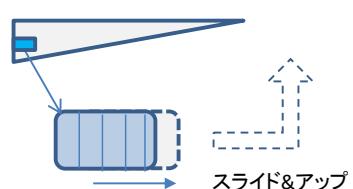


- 棚を載せる位置に左右にブラケットを平行に取付けます。

取付け方法

- ① 両側の支柱の穴にブラケットを押し込む。
- ② 押し込んで下に下げます。


取外し方法

- ① 透明のストップバーを親指と人差し指ではさむ。
- ② ストップバーを手前にスライドしながら上方方向に上げ手前に引く。

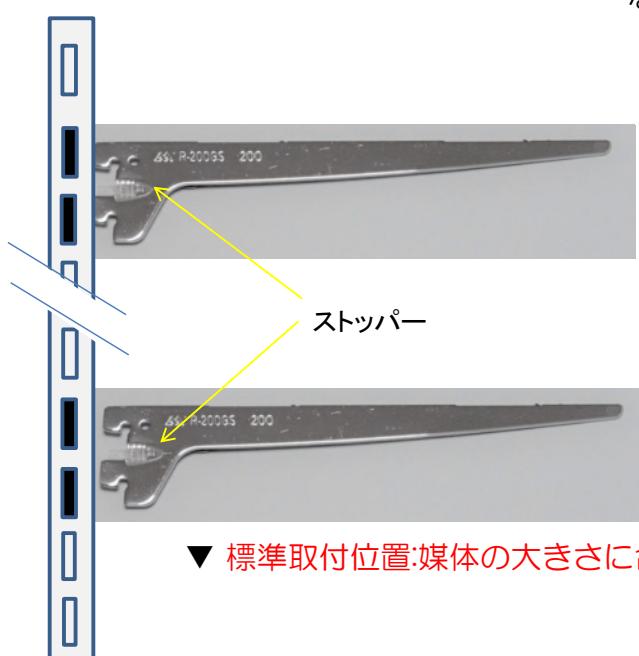


5. デンネツ除菌ランプの交換手順

Step-1 予備殺菌ランプ箱から飛散防止ラバーを取り出す

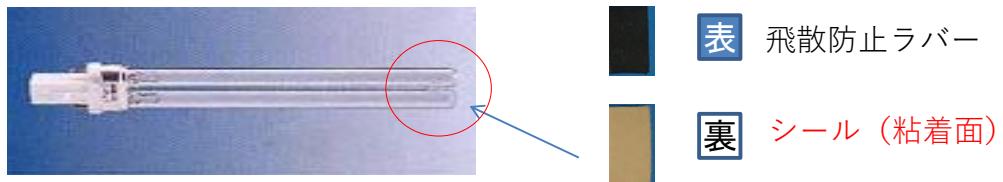

Step-2 ガードフレームを外す

① ガードフレームを下げる

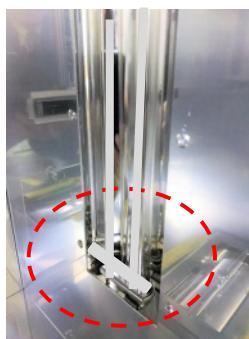


② フレームを押し下げる



③ 持上げ外す



Step-3 飛散防止ラバーの粘着面をランプのトップに張り付ける

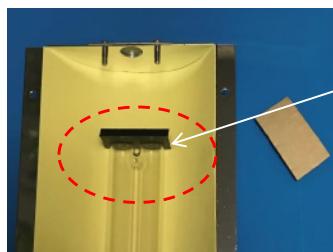

ラバーは交換用殺菌ランプ箱に説明書と同封されています。シールを剥がし粘着面をランプのトップに張り付ける。

ランプを抜くときランプボックスへの衝撃軽減、又破損防止の為のラバーです。使用後は交換したランプとともに廃棄してください。

Step-4 除菌ランプを外す


球管を上方向に抜いてください。

✖ 注意1 球管 前倒し厳禁

✖ 注意2 ゆっくり左右に振り
上方に抜いてください。

✖ 前倒し厳禁

◎ 上方向



Step-5 新しいランプを挿入

・装填時、球管の受口に合わせて挿入
カチット音がするまで差し込んでください。

6. メンテナンスについて

清掃/交換

● 庫内の清掃

【清掃】 本体や内部反射板のよごれは柔らかい布で拭きとってください。

注：ベンジン、シンナーは使用しないでください。

● デンネツ除菌ランプ交換

【交換】ランプの寿命は利用件数3万回余の利用回数で球切れが発生します。

例) 30回×25日×12=9,000回 30000/9000=3年余

注：ランプ寿命はON-OFFのスイッチングサイクルにより影響を受けます
ので目安としてください。

・除菌ランプの交換上の注意

- 電源オフ直後は熱を持っておりまので冷めていることの確認、
又は手袋等着用の上注意して行ってください。
- 除菌ランプの交換方法 “参照して実施してください。”
- 取付け後、球管、ガードバーに緩み（ガタ）がないことをご確認ください。
- 交換した球管は不燃ごみとして処理してください。

7. 問合せ先

KIYOME きよめ 問合せ

販売店

電話番号：

FAX 番号：

8. 保証書内容

保 証 書

この保証書（以下、本書という）は、製品設置日より下記期間中に故障が発生した場合に、本書にある保証規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。販売代理店名、設置日などの記入をお確かめいただくとともに、保証内容をよくお読みになり大切に保管してください。

●本書は、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きによる正常なご使用で設置日から下記保証期間中に故障した場合に、規定の範囲に対して無料修理を約束するものです。下表の記入欄に記載のない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認ください。

《保証規定》本書記載の装置に対して、下記保証を無料で履行いたします。

1. 保証期間内に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で装置が故障した場合には無料修理をさせていただきます。

2. 適用除外：保証期間内でも、以下の場合には保証いたしません。

①取扱説明書に示す取扱方法に従った正しい使用をされなかった場合。

②不当な修理や改造が原因と認められる故障および損傷。

③使用上、取扱上の過失または事故によって生じたと認められる故障および損傷。

④火災・地震・風水害・落雷、その他天災地変による故障および損傷。

⑤規格以外の電源および電圧で使用された場合の故障および損傷。

⑥付属部品（オプション）の破損・紛失（棚、ブラケット）。

⑦本書の提示がない場合、および設置日、お客様名、販売代理店名などの所定事項の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

3. 修理作業は、原則として製造元へのセンドバックにて行います。

運送される場合の送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。

また、出張による修理を行った場合は、出張に要する費用を申し受けます。

4. 本書記載の装置を使用できなかつたことによる不便さ、損失などの費用については負担いたしません。

5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は、再発行はいたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※本書は、明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従って本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間経過後の修理について不明な場合、本書記載の販売代理店にお問い合わせください。

7. 消耗品：取付開封時お気付きの点がございましたら速やかに販売代理店またはサービス受付までご連絡ください。

除菌ランプの保証期間：1年間。



製品名	デンネツ殺菌ボックスきよめ KCF-1 クリアファイル除菌タイプ		
出荷検印	印	製造番号	
保証期間	一年間保証	設置日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 〒		
販売店	電話番号		